

UMYWALKI CHIRURGICZNE STEROWANE BATERIA- MI ŁOKCIOWYMI


UCH L

CHARAKTERYSTYKA

- Umywalki chirurgiczne przeznaczone są do mycia rąk w blokach operacyjnych, przed przystąpieniem do zabiegu.
- Mogą być również stosowane w szpitalach personelu w oddziałach o podwyższonych wymogach sanitarnych, np.: salach zabiegowych, centralnych sterylizatorniach, itp.



Widok z boku

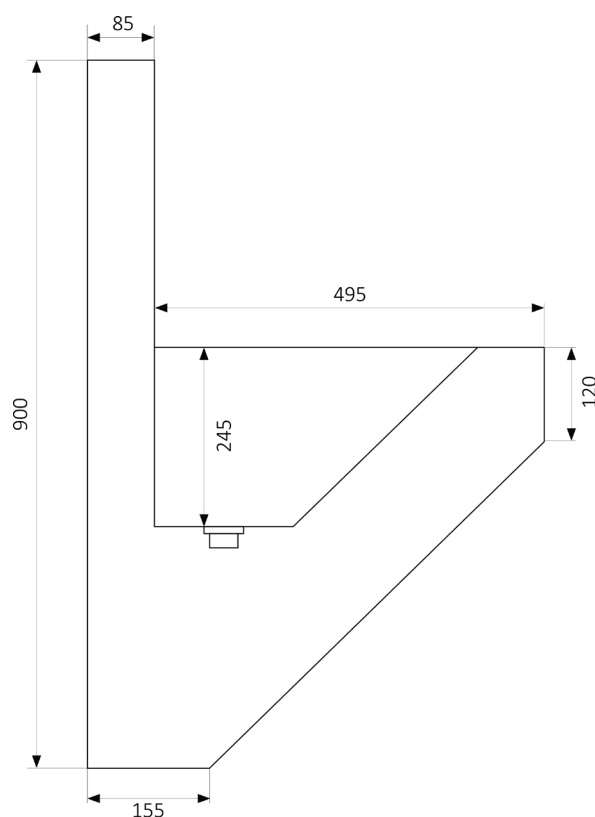

SPECYFIKACJA

Umywalki wykonane są ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 (1.403).

UCH L: korpus umywalki z zainstalowanymi bateriami łokciowymi, syfon, listwa montażowa.

Dodatkowo każda umywalka może być wyposażona w dozowniki mydeł i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na ręczniki, kosz na odpadki, pojemniki na szczotki chirurgiczne itp.

Gwarancja: 2-10 lat w zależności od wyposażenia

DANE TECHNICZNE

Podłączenie wody:

Umywalki UCH L: gwint zewnętrzny 2x1/2" do każdego stanowiska;

Odpływ: Ø 50 mm umieszczony centralnie;

Wymiary: wg rysunku powyżej. Zmienną jest długość (max 3000 mm oraz liczba stanowisk). Przyjmuje się 600 – 800 mm na stanowisko.



OPIS TYPÓW

Liczba stanowisk: 1 – 6

Maksymalna długość umywalki: 300 cm



Skala ul. Uzdrowskowa 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035
E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl