


UMYWALKI CHIRURGICZNE STEROWANE FOTOKOMÓRKĄ UCH Z

CHARAKTERYSTYKA

- Umywalki chirurgiczne przeznaczone są do mycia rąk w blokach operacyjnych, przed przystąpieniem do zabiegu.
- Mogą być również stosowane w służach personelu w oddziałach o podwyższonych wymogach sanitarnych, np.: salach zabiegowych, centralnych sterylizatorniach, itp.



Widok z boku

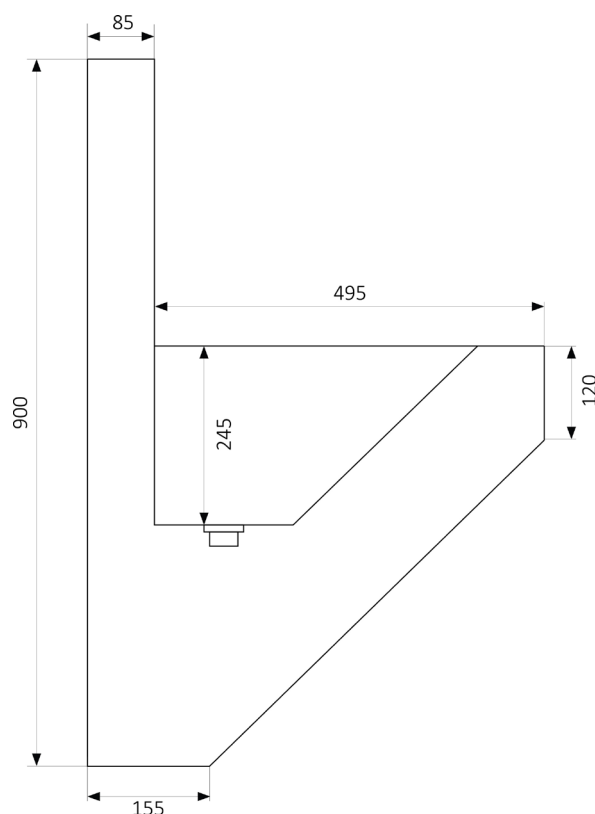

SPECYFIKACJA

Umywalki wykonane są ze stali kwasoodpornej typ AISI 304 (1.403).

UCH Z: korpus umywalki z kompletną instalacją wodną, mieszaczem termostatycznym lub mechanicznym, wylewka, syfon, czujniki podczerwieni z zasilaczem lub bateriami zasilającymi, listwa montażowa.

Umywalki o liczbie stanowisk 4 i większej posiadają 1 mieszacz o rozmiarze 3/4" lub dwa mieszacze o rozmiarze 1/2" – do ustalenia z inwestorem.

Dodatkowo każda umywalka może być wyposażona w dozowniki mydeł i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na ręczniki, kosz na odpadki, pojemniki na szczotki chirurgiczne itp.

Gwarancja: 2-10 lat w zależności od wyposażenia

DANE TECHNICZNE

Podłączenie wody:

Umywalki UCH Z: 1-3 stanowiskowe: mieszacz z gwintem zewnętrznym 2x1/2"; 4 i więcej stanowiskowe: mieszacz z gwintem zewnętrznym 2x3/4" lub dwa mieszacze 1/2"

Odptyw: Ø 50 mm umieszczony centralnie;

Wymiary: wg rysunku powyżej. Zmienną jest długość (max 3000 mm oraz liczba stanowisk). Przyjmuje się 600 – 800 mm na stanowisko.

OPIS TYPÓW

Zasilanie: UCH Zi – zasilanie z zasilacza 24V, UCH ZB – zasilanie z baterijki 6 – 9 V

Liczba stanowisk: 1 – 6

Maksymalna długość umywalki: 300 cm



Skala ul. Uzdrowskova 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035
E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl